



Главное управление
организации торгов
Самарской области



КАЧЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА ТОВАРА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАКУПКИ

2023 год



webtorgi.samregion.ru

Предпосылки:

- случаи поставки фальсифицированных изделий медицинского назначения (далее – ИМН) в медицинские учреждения Самарской области;
- отсутствие у заказчиков профессиональных знаний в области оценки качества ИМН;
- отсутствие четкой системной работы с поставщиками, обеспечивающей защиту интересов заказчиков.

Примеры ИМН, поставляемых по контрактам:



ПЕРЧАТКИ

Без каких либо повреждений, надрывов, дыр.

✓ **Хорошее качество.**

Структура материала однородная, без посторонних вкраплений.



✗ **Плохое качество.**

Перчатки имеют физические повреждения, разрывы, явно выраженные пятна, свидетельствующие о плохом качестве перчаток.



Упаковка индивидуальная и групповая без повреждений.

✓ **Хорошее качество.**

Индивидуальная и групповая упаковка без повреждений и нарушений целостности.



✗ **Плохое качество.**


Индивидуальная или групповая упаковки, имеющие явно выраженные физические повреждения.



На упаковке присутствует описание на русском языке, позволяющее идентифицировать содержимое.

✓ Хорошее качество.

На упаковке имеется информация о виде перчаток, регистрационном удостоверении, распространяющемся на данные перчатки, срок годности, номер партии/лота выпуска. Вся информация нанесена на русском языке, хорошо читаема без следов исправлений.

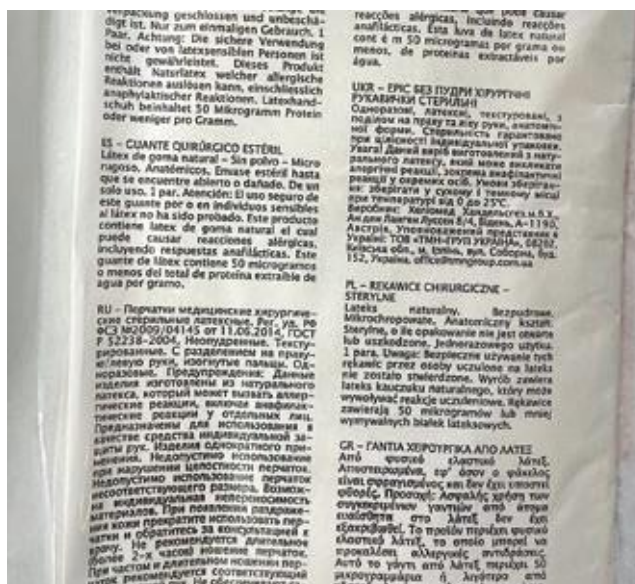

✗ Плохое качество.

На упаковке отсутствует информация на русском языке, а также не указан номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, свидетельствующий о том, что перчатки можно использовать в медицинских целях.



Однако поставляемый товар может иметь не только явные, но и скрытые недостатки качества.

Для выявления скрытых недостатков требуется определенный навык их обнаружения. Также необходима правильная фиксация выявленных недостатков и своевременное направление претензии с целью пресечения действий поставщика по поставке товара ненадлежащего качества и поставке им товара, соответствующего требованиям технического задания и спецификации контракта.

Поставляемый поставщиком товар в обязательном порядке должен соответствовать техническому заданию, спецификации к контракту и ГОСТам.

Таким образом, приемка товара начинается не с направления заявки поставщику или поставки товара на склад заказчика, а с надлежащего заполнения контракта.

Одним из наиболее важных моментов на данном этапе является четкое соответствие спецификации к контракту первой

части заявки на участие в закупке в части технических характеристик, страны происхождения, товарных знаков (при наличии) и наименований товара.

На основании правильно составленной спецификации к контракту заказчик подает заявку поставщику. Форма заявки является типовой (*Приложение № 1*).

Приемка товара заказчиком происходит в 2 этапа.

1 этап – проверка соответствия товара сопроводительным документам, проверка количества и размеров поставленного товара, проверка сроков годности товара, проверка сроков поставки, проверка наличия документов, подтверждающих соответствие медицинского изделия требованиям качества и безопасности.

2 этап – проверка документов, подтверждающих соответствие медицинского изделия требованиям качества и безопасности, проверка соответствия качества товара условиям технического задания.



Поставка товара поставщиком на склад заказчика

Водитель, доставивший товар, должен иметь при себе доверенность, позволяющую идентифицировать его как сотрудника организации поставщика либо как сотрудника транспортной компании, осуществляющей доставку.

Соответствие привезенного товара сопроводительным документам

Наименование товара в товарной накладной и на упаковке товара должны соответствовать друг другу.

Документ о приемке

Статус: 1

→ документ о приемке (акт) и счет-фактура
→ документ о приемке (акт)

Счет-фактура № 0005432 от 26.08.2022 (1)
Исправление № _____ от _____ (1а)

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес

Грузополучатель и его адрес

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке № n/p

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

(5)

(5а)

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
A	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
22.19.60.119	1	Перчатки смотровые/процедурные из латекса геви, неопудренные, нестерильные Размер S		715	Пара (2 шт.)	7500	4.08181818182	30613.64	без акциза	10%	3061.36	33675.00	276	ГЕРМАНИЯ	
22.19.60.119	2	Перчатки смотровые/процедурные из латекса геви, неопудренные, стерильные Размер M		715	Пара (2 шт.)	500	7.66363636364	3831.82	без акциза	10%	383.18	4215.00	643	РОССИЯ	
Всего к оплате (9)								34445.46	X		3444.54	37890.00			

Документ от поставщика

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Гриненко А. Ю.

(Ф.И.О.)

✓ Правильно

✗ Неправильно



www.CentrMag.ru

Соответствие количества и размеров товара заявке заказчика

Если поставлен товар одного вида, но разных размеров, то не допускается объединения товара в документе о приемке в одно наименование. Товары одного вида, но разных размеров, в документе о приемке должны быть указаны отдельными позициями.

Документ о приемке

Статус: 1

— документ о приемке (акт) и счет-фактура
— документ о приемке (акт)

Счет-фактура № 0005432 от 26.08.2022 (1)
Исправление № _____ от _____ (1а)

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке № п/п

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-МЕД"
443035, 63, Г САМАРА, ПР-КТ КИРОВА, ВЛД 255, КОМНАТА 405
6312012926/631201001
он же
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", 446250, 63, РАЙОН Безенчукский, ПОСЕЛОК ГО Безенчук, УЛИЦА МАМИСТОВА, 52
№ _____ от _____
1 № 0005432 от 26.08.2022
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
446250, 63, РАЙОН Безенчукский, ПОСЕЛОК ГО Безенчук, УЛИЦА МАМИСТОВА, 52
6362003934/636201001
Российский рубль, 643

(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(5а)
(6)
(6а)
(6б)
(7)
(8)

Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
446250, 63, РАЙОН Безенчукский, ПОСЕЛОК ГО Безенчук, УЛИЦА МАМИСТОВА, 52
6362003934/636201001
Российский рубль, 643

(8)
(8а)
(8б)
(8)

Документ от поставщика

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Гриненко А. Ю.
(подпись) (ф.и.о.)

✓ Правильно

Количество и размер каждого наименования поставленного товара в полном объеме должны соответствовать информации, указанной в документе о приемке, а также заявке заказчика.



✗ Неправильно

Поставлен товар одного размера, что не соответствует заявке Заказчика и документу о приемке.




Соответствие сроков годности товара техническому заданию, контракту и заявке заказчика

Остаточный срок годности товара, указанный на упаковке, должен соответствовать сроку годности, установленному техническим заданием, контрактом.

На каждое наименование поставленного товара должно быть предоставлено регистрационное удостоверение, информация о котором указана на упаковке товара.

Регистрационное удостоверение представляется в виде: оригинала/нотариально заверенной копии/копии, заверенной держателем.

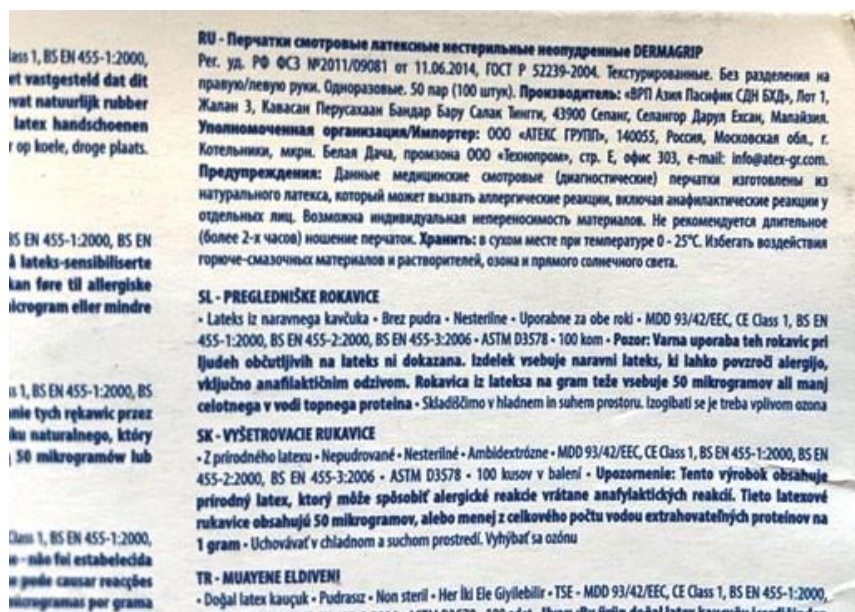


✓ Правильно

✗ Неправильно



В случае обнаружения при приемке товара одного или нескольких несоответствий составляется мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и направляется в адрес поставщика для устранения выявленных недостатков.

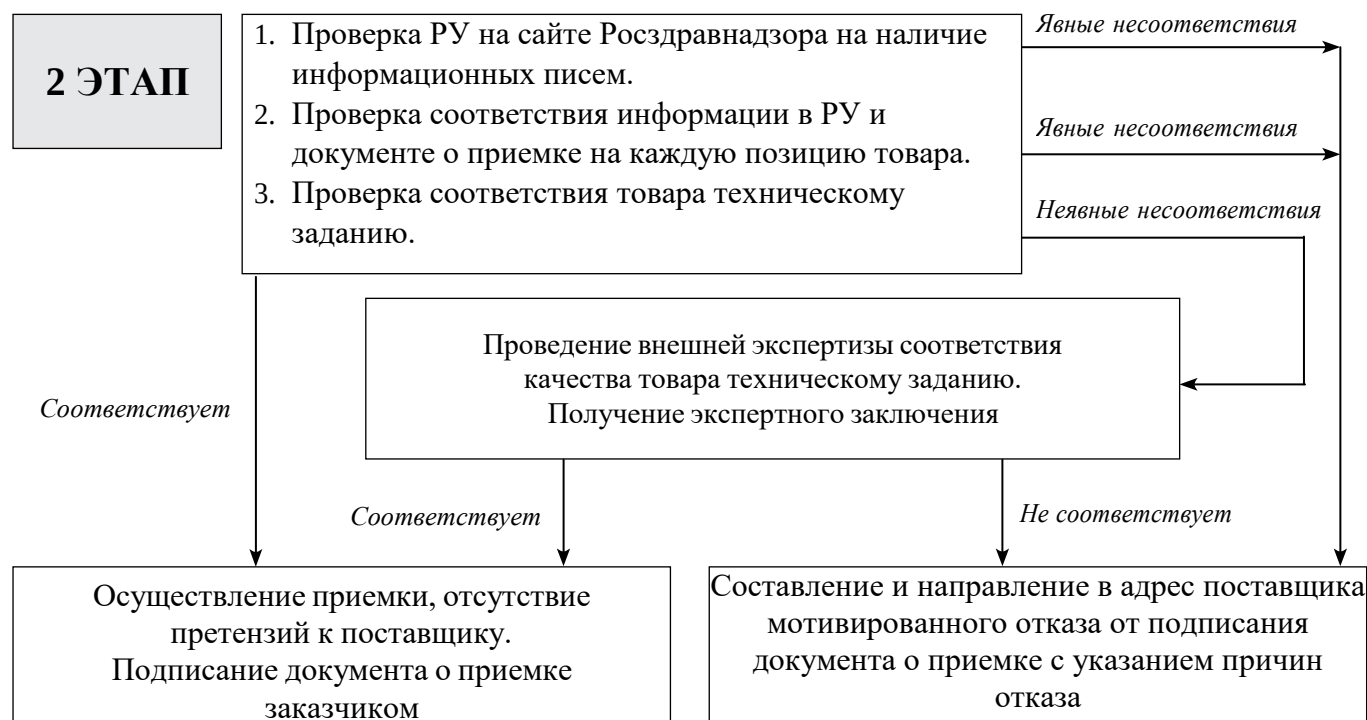


Проверка регистрационных удостоверений на сайте Росздравнадзора на предмет наличия информационных писем


Проверка соответствия информации в регистрационном удостоверении и документе о приемке по каждой позиции товара

Обязательным условием приемки поставленного товара является проверка представленных с товаром регистрационных удостоверений на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения <https://roszdravnadzor.gov.ru>.

Поиск регистрационного удостоверения осуществляется в разделе «Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий», который находится во вкладке «Сервис», расположенном вверху главной страницы сайта.

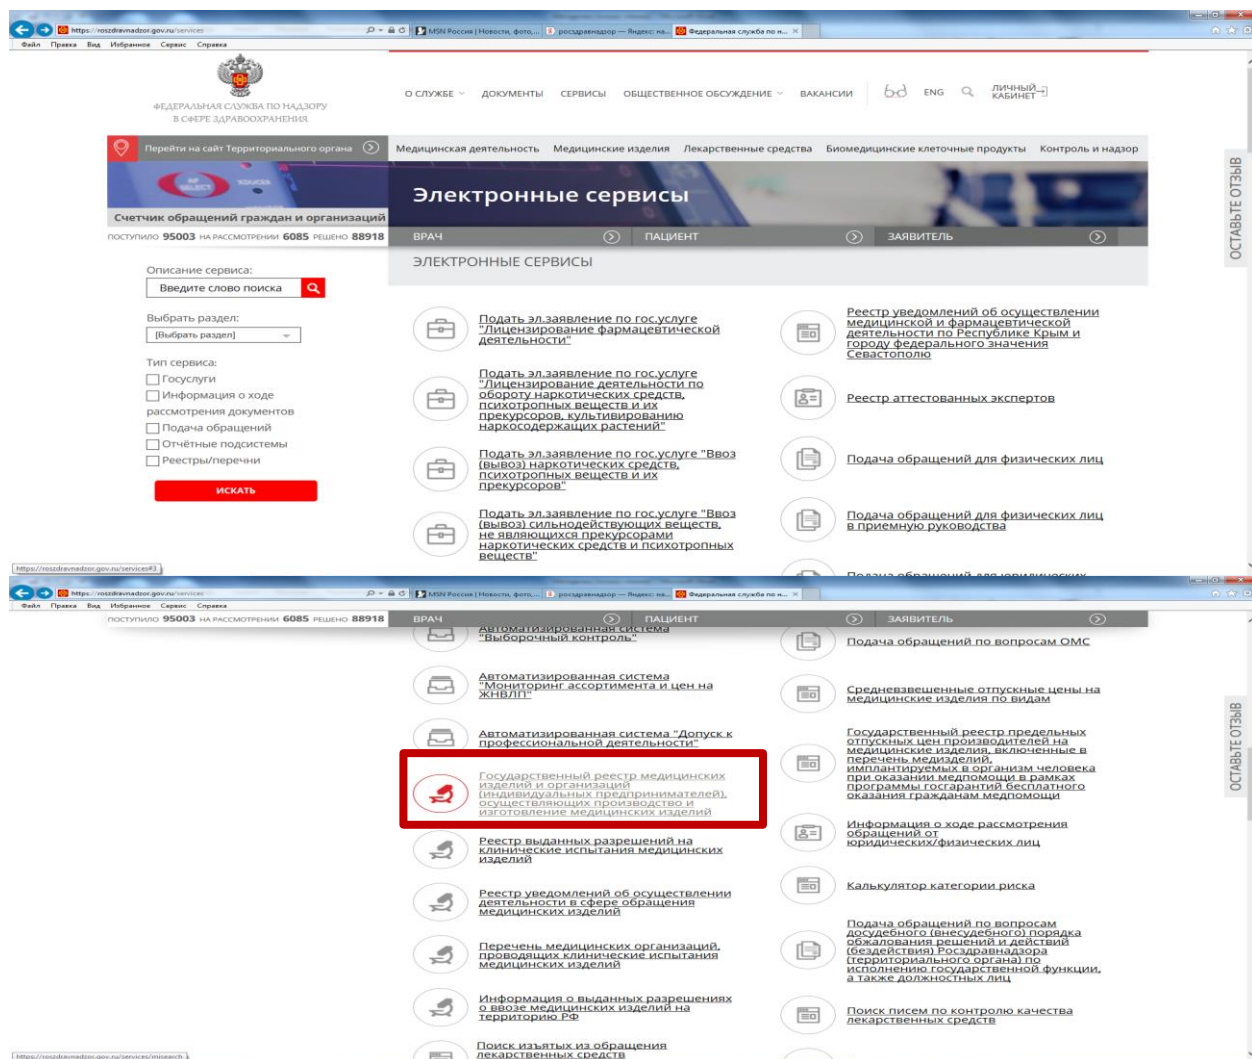

В строке поиска вводится номер регистрационного удостоверения и появляются результаты поиска.

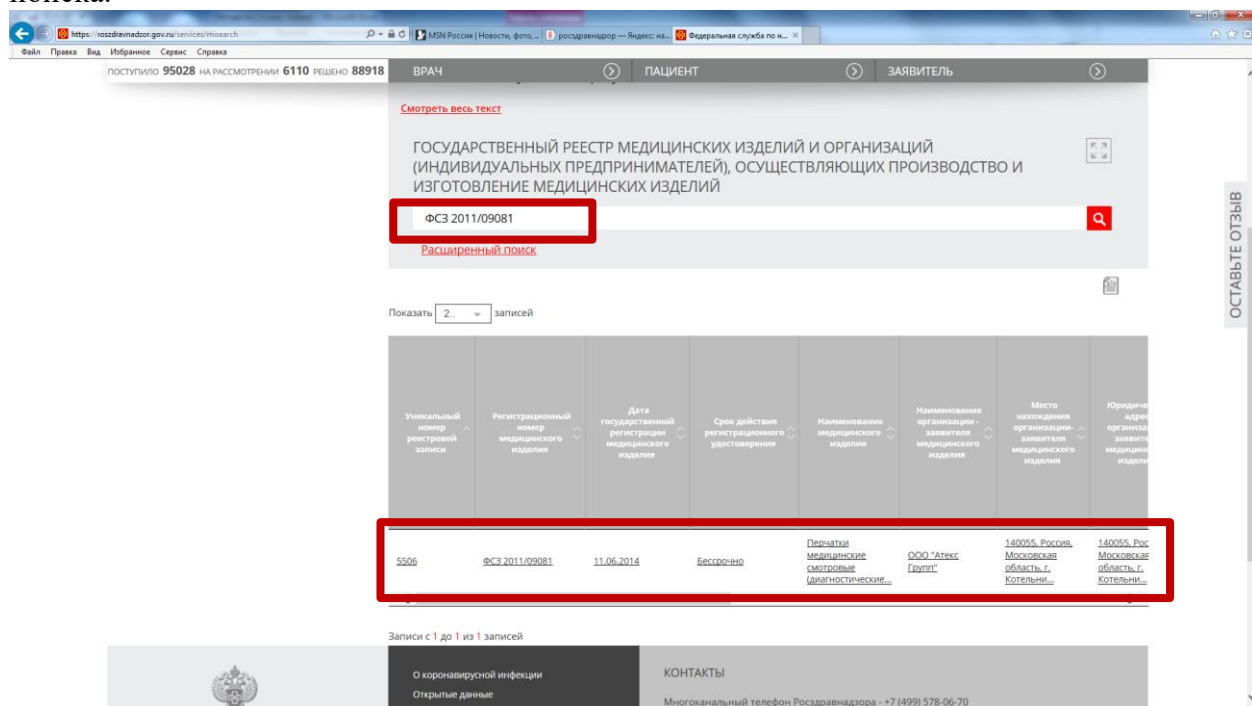

Также, используя ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, можно получить следующую дополнительную информацию:

- страна производства;
- класс потенциального риска применения;

Параметр изделия	Значение параметра изделия
Уникальный номер реестровой записи	5506
Регистрационный номер медицинского изделия	ФСЗ 2011/09081 [Скачать РУ]
Дата государственной регистрации медицинского изделия	11.06.2014
Срок действия регистрационного удостоверения	Бессрочно
Наименование медицинского изделия	Перчатки медицинские смотровые (диагностические) латексные и синтетические, стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные 1. Перчатки смотровые латексные стерильные неопудренные DERMAGRIP. 2. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные DERMAGRIP. 3. Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные COMFIT. 4. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные DERMAGRIP High Risk. 5. Перчатки смотровые из синтетического латекса (нитрил) нестерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile. 6. Перчатки смотровые из синтетического латекса (нитрил) стерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile Sterile.
Наименование организации-заведателя медицинского изделия	ООО "Атекс Групп"
Место нахождения организации-заведателя медицинского изделия	140055, Россия, Московская область, г. Котельники, микрорайон «Белая дача», промзона «Технопром», стр. Е, офис 303
Юридический адрес организации-заведателя медицинского изделия	140055, Россия, Московская область, г. Котельники, микрорайон «Белая дача», промзона «Технопром», стр. Е, офис 303
Наименование организации-производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия	"ВРП Азия Пасифик СДН БХД"
Место нахождения организации-производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия	, Малайзия, Дальнее зарубежье, WRP Asia Pacific SDN BHD, Lot 1, Jalan 3, Kawasan Perusahaan Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Юридический адрес организации-производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия	, Малайзия, Дальнее зарубежье, WRP Asia Pacific SDN BHD, Lot 1, Jalan 3, Kawasan Perusahaan Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
ОКПД/ОКПД2	25 1460
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации	1
Назначение медицинского изделия, установленное производителем	
Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации	—
Адрес места производства или изготовления	

- коды вида медицинского изделия (соответствуют НКМИ в КТРУ) указанные в регистрационном удостоверении;

Код вида	Наименование модели
122510	1. Перчатки смотровые латексные стерильные неопудренные DERMAGRIP
122540	2. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные DERMAGRIP
122560	3. Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные COMFIT
122540	4. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные DERMAGRIP High Risk
185830	5. Перчатки смотровые из синтетического латекса (нитрил) нестерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile
185700	6. Перчатки смотровые из синтетического латекса (нитрил) стерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile Sterile

- наличие изменений, вносимых в информацию о ИМН, а также писем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по ограничению обращения ИМН, либо конкретного лота изделия, с данным регистрационным удостоверением.

https://rosdraznadzor.gov.ru/services/misearch

3. Перчатки смортовые латексные нестерильные отпудренные COMFIT

4. Перчатки смортовые латексные нестерильные неопудренные DERMAGRIP High Risk

5. Перчатки смортовые из синтетического латекса (нитрил) нестерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile

6. Перчатки смортовые из синтетического латекса (нитрил) стерильные неопудренные DERMAGRIP Nitrile Sterile

ИСТОРИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Уникальный номер регистрационной записи	Регистрационный номер медицинского изделия	Дата государственной регистрации медицинского изделия	Срок действия регистрационного удостоверения	Наименование медицинского изделия	Наименование организации - заявителя медицинского изделия
044439	ФСЗ 2011/09081	28.03.2011		Перчатки медицинские смортовые (диагностические) латексные и синтетические	Общество с ограниченной ответственностью "Медком-МП"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА ПО МИ

№ документа	Дата	Тема	Файл
1.	01И-1597/15 от 05.10.2015	О приостановлении применения медицинского изделия	2045408.pdf [скачать]
2.	01И-1985/15 от 19.11.2015	О приостановлении применения медицинского изделия	2052149.pdf [скачать]

- информационные письма о безопасности применения медицинских изделий (отмена РУ, недоброкачественная продукция, фальсификат и т.д.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ

О СЛУЖБЕ ДОКУМЕНТЫ СЕРВИСЫ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВАКАНСИИ ENG Личный кабинет

Перейти на сайт Территориального органа

Счетчик обращений граждан и организаций
 ОСТУПИЛО 166031 НА РАССМОТРЕНИИ 9166 РЕШЕНО 156865

Медицинская деятельность Медицинские изделия Лекарственные средства Биомедицинские клеточные продукты Контроль и надзор

Регистрация медицинских изделий
 Регистрация медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза
 Внесение изменений в регистрационные документы и регистрационные удостоверения на медицинские изделия
 Ввоз медицинских изделий в целях их государственной регистрации
 Вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения
 Незарегистрированные медицинские изделия для диагностики in vitro
 Клинические испытания медицинских изделий
 Контроль за обращением медицинских изделий
 Мониторинг безопасности медицинских изделий
 Лицензирование деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий
 Регулирование цен на медицинские изделия
 Уведомления о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий
 Формирование перечня спиртосодержащих медицинских изделий

№ инф. письма	Дата письма	Дата публикации	Наименование медицинского изделия	Номер РУ	Дата РУ	Производитель	Тема письма	Файл письма	№ деп. письма	Дата деп. письма
По заданным параметрам сведений не найдено. Попробуйте изменить параметры поиска.										

О коронавирусной инфекции
 Открытые данные
 Вестник Росздравнадзора
 Публичная декларация
 Перечень обязательных требований
 Противодействие коррупции
 Конкурсные закупки
 Карта сайта
 Архив

КОНТАКТЫ
 Многоканальный телефон Росздравнадзора - +7 (499) 578-06-70
 Справочная Росздравнадзора - +7 (499) 578-02-20
 «Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья - +7 800 550 99 03
 Техническая поддержка сайта
 Социальные сети: VK, OK, Rutube, Telegram

Проверка соответствия качества поставленного товара

Характеристики товара, указанные в техническом задании, условно разделяются на явные и неявные. Явные характеристики товара являются очевидными при осмотре товара, к ним относятся такие параметры, как длина, ширина, текстура, опудренность, тип укладки. Неявные характеристики, в частности, толщина, растяжение, являются неочевидными, их оценка требует привлечения экспертов, экспертных организаций.

В случае выявления нарушений условий технического задания по явным характеристикам следует оперативно составить претензию в адрес поставщика с требованием о замене товара на товар надлежащего качества.

В случае, если у приемочной комиссии возникли сомнения в качестве поставленного товара, заказчик имеет право:

- обратиться к официальному дистрибьютору на территории России данного товара, указанному на упаковке;

- провести внешнюю экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

На основании полученных результатов в сроки, установленные контрактом, заказчик подписывает документ о приемке (в случае создания приемочной комиссии такой документ подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В целях обеспечения принципов открытости и прозрачности в сфере государственных закупок документ о приемке размещается в единой информационной системе не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке.

На бланке ЛПУ

Директору ООО «*****»
Иванову Ивану Ивановичу

Исх. № от _____

Заявка

на приобретение перчаток

по контракту № _____ от _____

Согласно спецификации:

№ п / п	Наименование товара	Характеристики товара		Единица измерения	Количество	Страна происхождения товара
3	Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные	Нормативный документ	ГОСТ Р 52238-2004	ПАР	5,5-25 пар 6,5-50 пар 7,5-50 пар 8,5-25 пар 9,5-50 пар	Китай
		Стерильность	Стерильные			
		Форма	Анатомическая			
		манжета	с валиком			
		Упаковка	2 пары в упаковке, каждая в индивидуальной упаковке			
		Размер	5;5,5;6;6,5;7;7,5;8;8,5;9;9,5 (по согласованию с Заказчиком)			
		Кратность применения	одноразовые			
		Поверхность	Неопудренные			
		Длина,мм	не менее 290			
		Текстура	Наличие (текстурированная поверхность)			
		Толщина	Наружняя перчатка: одинарная (на расстоянии 0,15±3мм от вершины среднего пальца), не более 0,24мм . Внутренняя перчатка: одинарная (на расстоянии 0,15±3мм от вершины среднего пальца), не более 0,18мм			
		Система защиты от повреждений	Индикация проколов по средством контрастных цвету кожи внутренних перчаток и контрастному цвету наружной к цвету внешней перчаток			
		Степень защиты	класс потенциального риска применения не ниже 2а			
		Удлинение при разрыве	до старения не менее 650%			
		Прочность на разрыв	до ускоренного старения не менее 9Н			
		Покрытие внутри	полимерное			
		Покрытие снаружи	полимерное			
		Материал изготовления	Полиизопрен			

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Самара, пр. Юных пионеров, д. 141/д.55

Сроки поставки товара, завершения работ, график оказания услуг: по заявке заказчика в течение пяти календарных дней, с момента заключения контракта по 31.12.2021 года. О дате поставки товара Поставщик извещает Заказчика не менее чем за три рабочих дня.

Условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (устанавливаются при необходимости):

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от всего срока годности товара, если меньший остаточный срок годности не предусмотрен информационной картой документации об электронном аукционе.

Поставляемый товар, а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам и/или документам, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в случае если установлено соответствующее требование в описании объекта закупки.

К поставке должны быть приложены все документы согласно п.5.2 контракта № _____ от _____

Подпись
Печать

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГБУЗ СО «*****»

_____ Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРА

«__» _____ г.

Адрес ЛПУ

1. Объект исследования

Поставка товара по контракту № ____ от _____ г. для нужд _____ по Заявке Заказчика исх. № ____ от _____ г. в соответствии с документом о приемке № ____ от _____ г.

Исследование проводилось путем осмотра товара, сопоставления представленных документов и информации о товаре условиям технического задания, контракта, заявке Заказчика.

Использовался метод анализа: визуальный метод.

Визуально выявлялось:

- соответствие товара на предмет соответствия требованиям извещения, технического задания, контракта и нормативно-технической документации.
- наличие и место расположения дефектов, недостатки.

2. Выводы

1. Поставленный товар сопроводительной документации поставщика – *соответствует / не соответствует.*
2. Поставленный товар Заявке Заказчика – *соответствует / не соответствует.*
3. Поставленный товар требованиям технического задания заключенного контракта, техническому заданию, опубликованному в составе документации и предложению поставщика – *соответствует / не соответствует.*
4. Срок годности поставленного товара требованиям технического задания заключенного контракта, техническому заданию, опубликованному в составе документации и предложению поставщика – *соответствует / не соответствует.*
5. Фактические сроки поставки товара по исполненному контракту, срокам, указанным в заключенном контракте и срокам, указанным в опубликованной документации – *соответствуют / не соответствуют.*
6. Наличие всех документов согласно п. ____ заключенного контракта – *имеются / не имеются.*
7. Наличие дефектов в поставленном товаре – *имеются / не имеются.*
8. Основания для применения штрафных санкций в отношении поставщика – *имеются / не имеются.*
9. Поставленный товар – *подлежит приемке / не подлежит приемке.*

Выявлены следующие нарушения требований контракта, не препятствующие приемке:

В целях устранения выявленных нарушений Поставщику предлагается самостоятельно забрать товар, поставленный Заказчику в соответствии с документом о приемке № ____ от _____ г., и в течение 5 (пяти) дней с момента возврата товара поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 2 к контракту № ____ от _____ г.) и Заявке Заказчика исх. № ____ от _____ г.

Члены комиссии:

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководителю Территориального органа
Росздравнадзора

от

Уважаемый _____!

«___» _____ г. по результатам проведения закупки на _____ между
_____ и _____ заключен контракт № _____ от «___» _____ г.

В рамках исполнения данного контракта «___» _____ г. в адрес _____ была
направлена заявка на поставку товара (Приложение №1).

«___» _____ г. в соответствии с документом о приемке № _____ от «___»
_____ г. товар был поставлен Заказчику (Приложение №2).

Однако, при осуществлении приемки поставленного товара было установлено следующее.

(Указываются выявленные нарушения)

_____.

Причинами для обращения в Территориальный орган Росздравнадзора могут быть:

- наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие в информационных базах данных о приостановлении или изъятии из обращения медицинских изделий;
- полное либо частичное несоответствие маркировки (ГОСТа, характеристики и др.), нанесенной на упаковку, регистрационному удостоверению;
- в представленном регистрационном удостоверении нет кода вида медицинского изделия, соответствующего поставленной продукции, и др.

На основании изложенного прошу:

- провести проверку соблюдения субъектом обращения медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий;
- в случае выявления нарушений выдать предписание об их устранении, привлечь виновных лиц к административной ответственности;
- направить материалы проверки в органы прокуратуры, правоохранительные органы в случае выявления нарушений, содержащих признаки преступления.

Приложения:

Главный врач

(подпись)


Ф.И.О.

Расторжение контракта в одностороннем порядке

Основания для одностороннего отказа

- поставщик не передает товар;
- поставка товара ненадлежащего качества с неустранимыми недостатками;
- товар поставлен без необходимых документов;
- неоднократное нарушение сроков поставки товаров;
- поставщик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- поставщик (исполнитель) не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) информации о товаре таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
- неукomплектованный товар в установленный заказчиком разумный срок не был доукомплектован.

Этапы и сроки расторжения контракта в соответствии со ст.95 Закона № 44-ФЗ:

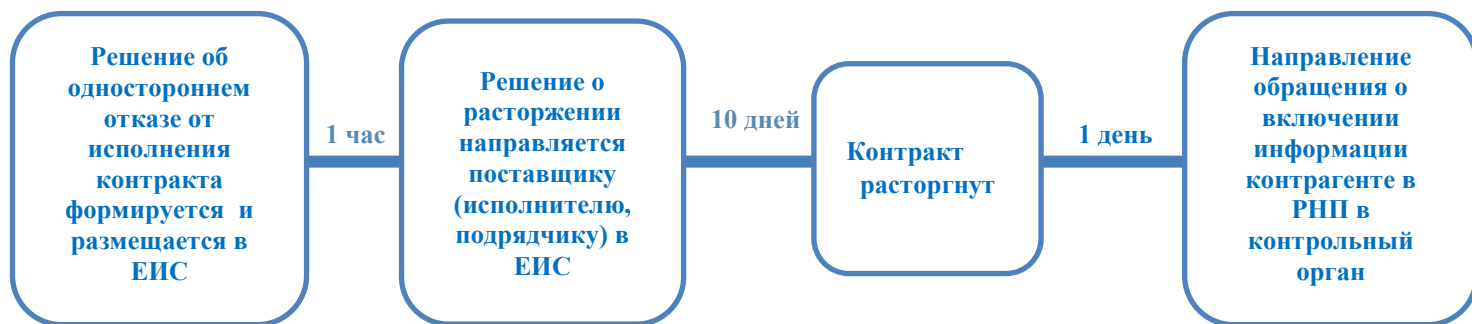

Дата надлежащего уведомления контрагента о расторжении контракта согласно части 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ:

- дата поступления поставщику (исполнителю, подрядчику) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой он расположен.

Перечень документов для включения в РНП:

- ☐ обращение о включении в РНП сведений об участнике закупки, формируемое посредством ЕИС;
- ☐ решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (прилагается в ЕИС автоматически).

 (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))
 адрес: _____,
 телефон: _____,
 от _____
 (наименование заказчика)
 адрес: _____,
 телефон: _____

**Требование (претензия) об уплате неустойки (штрафа, пени)
 в связи с просрочкой исполнения (неисполнением / ненадлежащим исполнением) обязательств
 (гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
 при осуществлении закупки товара (работы, услуги)**

"__" ____ г., в соответствии со ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" между _____ (наименование Заказчика) (далее-Заказчик) и _____ (наименование Поставщика (подрядчика, исполнителя)) (далее-Поставщик (подрядчик, исполнитель)) был заключен государственный контракт № _____ (далее – Контракт) на поставку/выполнение работ/оказание услуг по _____, в соответствии с которым Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязался поставить _____/выполнить работы по _____/оказать услуги по _____, а Заказчик обязался принять и оплатить поставленный товар/выполненные работы/оказанные услуги по _____.

ОБРАЗЕЦ текста претензии в случае просрочки исполнения обязательств:

Согласно п. _____ Контракта обязательство по поставленному товару/выполненной работе/оказанной услуге _____ должно быть исполнено Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в срок до "__" ____ г.

Вместе с тем данное условие Контракта было нарушено, фактически Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство было исполнено "__" ____ г., что подтверждается _____. Просрочка составила _____.

В п. ____ Контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

Таким образом, размер пени составляет _____ (_____) рублей.

ОБРАЗЕЦ текста претензии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств:

В соответствии с условиями Контракта обязательство по поставленному товару/выполненной работе/оказанной услуге _____ должно быть исполнено Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. ____ Контракта.

Вместе с тем обязательство не было исполнено Поставщиком / было исполнено Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ненадлежащим образом, а именно: _____, что подтверждается _____.

В п. ____ Контракта стороны установили, что в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание штрафа в размере _____ (_____) рублей.

В соответствии с ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", необходимо в срок до "__" ____ г. уплатить неустойку (штраф, пени) в связи с просрочкой исполнения (неисполнением/ ненадлежащим исполнением) обязательств (гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: _____.

В случае неудовлетворения данного требования будем вынуждены осуществить взыскание вышеуказанной суммы с обеспечения исполнения контракта в силу пункта ____ контракта. В случае недостаточности средств обеспечения исполнения контракта или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание будет осуществлено в судебном порядке.

Приложения:


1. Документы, подтверждающие просрочку исполнения (или неисполнение / ненадлежащее исполнение) обязательств.
2. Расчет суммы требования (претензии).
3. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя.

"__" ____ г.


 (подпись)
 М.П.

 (Ф.И.О.)

Требования к маркировке изделий медицинского назначения



- Указывает дату, когда было
изготовлено медицинское изделие



- Указывает дату, после истечения,
которой изделие должно применяться или
использоваться




- Указывает код партии, которым
изготовитель идентифицировал партию изделия



- Указывает, что изделие не
подвергалось стерилизации




- Необходимость защиты груза от
воздействия влаги




- Груз следует защищать от


солнечных лучей



- Указывает границы температурного
диапазона, в пределах которого медицинское
изделие может быть применено без ущерба его
безопасности



- Указывает, что медицинское
изделие предназначено для однократного
применения или для использования в отношении
одного пациента в течение одной процедуры



- Указывает на необходимость для
пользователя ознакомиться с инструкцией по
применению



- Указывает, что натуральный каучук
или сухой натуральный каучук используется в
составе медицинского изделия или в его упаковке

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЕМКИ ТОВАРА

ПРОВЕРИТЬ	СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
I. Соответствие документов:		
А) сравнение технического задания (контракта) с УПД	☐	☐
	наименование, описание, размерный ряд, количество соответствуют	наименование, описание, размерный ряд, количество НЕ соответствуют
Б) сравнение регистрационного удостоверения указанного в контракте (при наличии) с предоставленным	☐	☐
	по п. 5.2 контракта копия регистрационного удостоверения заверена нотариально уполномоченным органом/держателем	заверено поставщиком или не заверено
В) наличие инструкции по применению (при наличии)	☐	☐
Г) проверка регистрационного удостоверения на сайте Росздравнадзора	☐	☐
	указан нужный товар, действует, нет информационных писем об отзыве на конкретную партию	указан не тот товар/регистрационное удостоверение не действует/ имеются информационные письма об отзыве представленной партии
II. Соответствие товара:		
А) сравнение характеристик товара, заявленных в техническом задании/контракте с предоставленными: - количество штук в упаковке; -длина изделия; - текстура; - манжета; - опудренность; - стерильность; - цвет; - кратность использования; - иные характеристики, позволяющие визуально определить целостность и соответствие поставленного изделия.	☐	☐
	товар соответствует заявленной упаковке производителя и техническому заданию	не соответствует

Б) соответствие поставленного количества товара заявке и контракту	☐	☐
В) соответствие срока годности поставленного товара	☐	☐
Г) требования к упаковке товара: - наименование или торговая марка изготовителя; - материал изготовления; - слова "ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ" или "ГЛАДКИЕ", "ОПУДРЕННЫЕ" или "НЕОПУДРЕННЫЕ"; - размер; - номер партии; - слово "ОДНОРАЗОВЫЕ"; - слова "НЕСТЕРИЛЬНЫЕ" или "СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ"; - слова "ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ"; - слова "ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ", а также год цифрами четырех разрядов и месяц изготовления; - информация об ; - ссылка на ГОСТ, ТУ производителя; - символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации по ГОСТ Р ИСО 15223-1 (см стр.); - транспортная маркировка по ГОСТ 14192;	☐	☐

